


AGCU Expressmarker 22荧光检测试剂盒

本试剂盒采用五色荧光标记系统,可同时扩增21个常染色体STR基因座以及1个性别基因座。

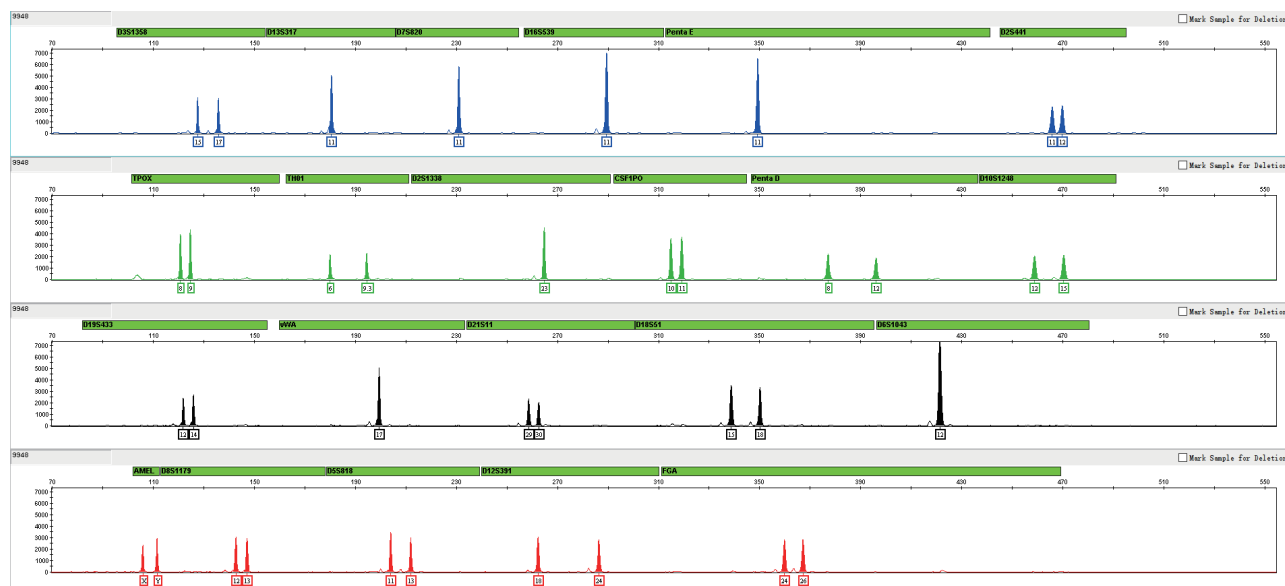

AGCU Expressmarker 22荧光检测试剂盒9948分型图

产品特点

快速高效

本试剂盒最快理论扩增时间87min。

免提直扩

对主流血卡或唾液卡可进行直接扩增而无需模板提取和纯化,同时适用于提取的DNA模板。




产品详情

PRODUCT INFORMATION



试剂盒排布

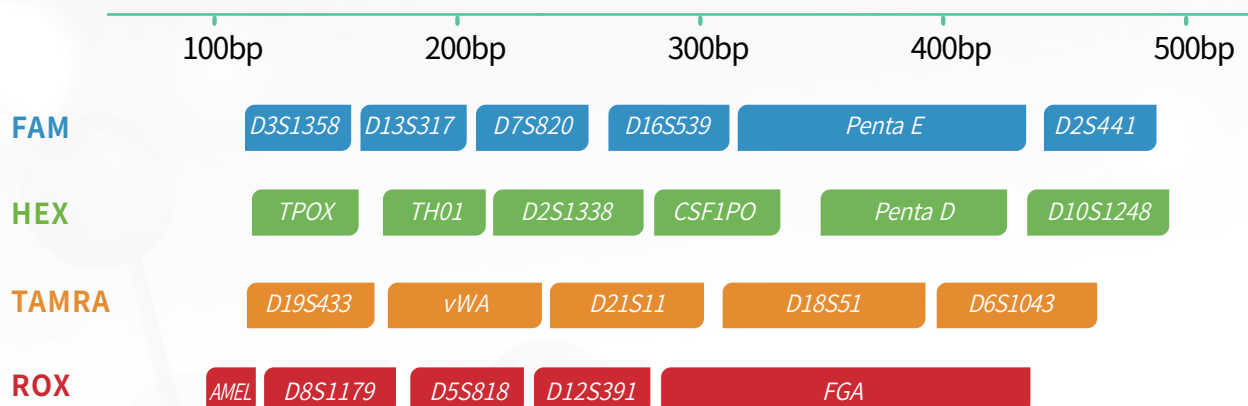

试剂盒组成

本试剂盒可供200次样品实验

扩增前试剂盒

SUPER Mix	1000μL×2支	含PCR缓冲液、MgCl ₂ 、dNTP Mix、酶
EX22 Primers	1000μL×1支	含有荧光标记引物等的混合物
Control DNA 9948	20μL×3支	含 0.5ng/μL 9948基因组 DNA
sdH ₂ O	1000μL×2支	超纯水

扩增后试剂盒

EX22 Allelic Ladder	50μL×1支	等位基因分型标准参考物
AGCU Marker SIZ-500	250μL×1支	荧光分子量内标

产品订购信息

产品名称	规格	货号
AGCU Expressmarker 22荧光检测试剂盒	200反应	600007-2
AGCU Y SUPP Plus荧光检测试剂盒	100反应	600053

